

室内质控 (IQC) 数据回报操作程序图示

在打开 EQA 质评上报表时，将首先出现 IQC 数据上报表，待回报 IQC 数据后才能进入 EQA 回报页面。

上报主题：2018年9月全国常规化学检测项目室内质控信息上报

(1) 质控品生产厂家名称、采用质控规则、质控物具体批号可以填写中文、英文、数字和符号。
 (2) 质控品平均浓度、质控物浓度标准差、当月在控制数据变异系数和累计在控制数据变异系数栏中填写数字，小数点后面可以保留3位。
 (3) 当月质控结果个数：填写整数。
 (4) “原始数据”可以不上报。

原始数据不需上报

发送


实验室主任： 电话： (区号)- 医院等级：

项目	原始数据	是否开展 IQC	质控物生产厂家名称	采用质控规则	质控物具体批号	9月在控质控结果的平均值	9月在控质控结果的标准差 (SD)	9月在控质控结果的个数 (N)	9月在控制数变异系数 (CV%)	累积在控制数据的变异系数 (CV%)	你室绘制质控图平均值	你室绘制质控图标准差 (SD)	你室绘制质控图变异系数 (CV%)	
钾 (mmol/L)	结果	是	厂家名称	1:3s/2:2s/4:1:	增加批号	123456	5.65	0.11	29	1.95	2.20	5.6	0.12	2.14
钠 (mmol/L)	结果	是	厂家名称	1:3s/2:2s	增加批号	HE1234	110	1.39	30	1.26	1.28	111	1.42	1.28
钠 (mmol/L)	结果	是	厂家名称	1:3s/2:2s	删除批号	HE1234	145	1.75	30	1.21	1.29	146	1.83	1.25
氯 (mmol/L)	结果				增加批号									
总钙 (mmol/L)	结果				增加批号									
磷 (mmol/L)	结果	否			增加批号									
血糖 (mmol/L)	结果	否			增加批号									
尿酸 (mmol/L)	结果	否			增加批号									
尿酸 (μmol/L)	结果				增加批号									
肌酐 (μmol/L)	结果				增加批号									
总蛋白 (g/L)	结果				增加批号									
白蛋白 (g/L)	结果				增加批号									
胆固醇 (mmol/L)	结果				增加批号									

若有多个水平质控物 请点击“增加批号”

若指定项目未开展室内质控 请点击“否”

若需要查看已上报数据，点击页面左侧“室内质控信息”菜单，点击“已上报数据”，选择专业和年份打开查看；若需重新上报数据，在此页面点击“重新上报”即可。

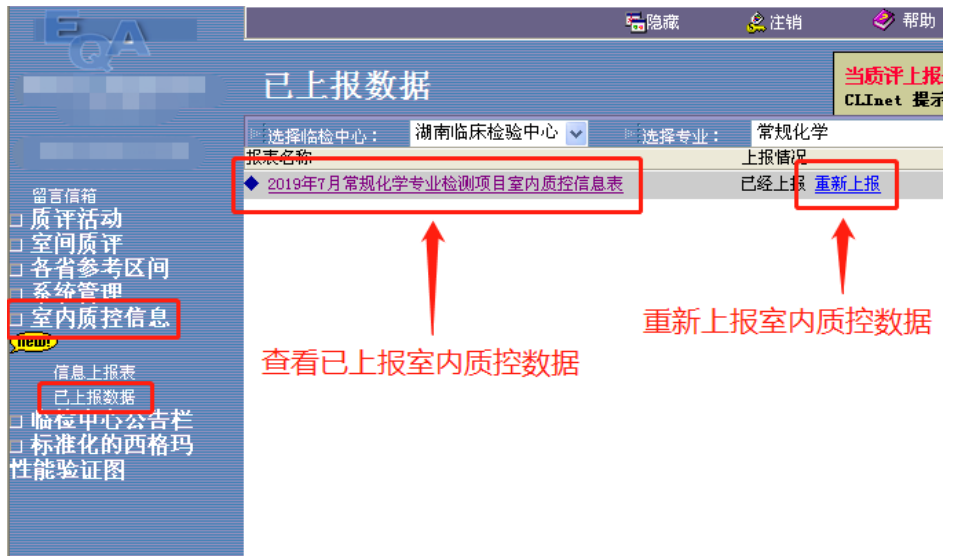

若数据填报不完整可点击“信息上报表”，选择相应专业后，点击“继续上报”。

