

基于 Web 室间质评软件回报室内质控数据 操作程序

1、打开湖南省临床检验中心网站（www.hncc1.com.cn），在“EQA 会员登陆”处，输入实验室编码和密码登陆。

2、进入室间质评回报页面，打开质评上报表，将首先出现室内质控数据上报表，待回报室内质控数据后才能进入 EQA 回报页面。

3、需要上报的专业和具体项目见每次室间质评活动通知。

4、若有多个水平质控物，请点击“增加批号”；若指定的项目未开展室内质控，在“是否开展 IQC”一栏选“否”。质控原始数据不需上报（见图 1）。

5、填报完毕后点击“发送”。若需要查看已上报数据、重报或修改数据，可点击页面左侧“室内质控信息”主菜单，进入“已上报数据”页面进行相关操作（见图 2）。若在填报途中不慎关闭了 IQC 上报页面，再次打开 EQA 回报表时，将不再弹出 IQC 上报页面，可点击“室内质控信息”主菜单，进入“信息上报表”，选择专业，点击相应月份的回报表再次上报或点击“继续上报”（见图 3）。

室内质控 (IQC) 数据回报操作图示

上报主题：2018年9月全国常规化学检测项目室内质控信息上报

(1) 质控品生产厂家名称、采用质控规则、质控物具体批号可以填写中文、英文、数字和符号。
 (2) 质控品平均浓度、质控物浓度标准差、当月在控制数据变异系数和累计在控制数据变异系数栏中填写数字，小数点后面可以保留3位。
 (3) 当月质控结果个数：填写整数。
 (4) “原始数据”可以不上报。

发送

实验室主任： 电话： (区号)- 医院等级：

项目	原始数据	是否开展 IQC	质控物生产厂家名称	采用质控规则	质控物具体批号	9月在控质控结果的平均值	9月在控质控结果的标准差 (SD)	9月在控质控结果的个数 (N)	9月在控制数据变异系数 (CV%)	累积在控制数据的变异系数 (CV%)	你室绘制质控图平均值	你室绘制质控图标准差 (SD)	你室绘制质控图变异系数 (CV%)	
钾 (mmol/L)	结果	是	厂家名称	1:3s/2:2s/4:1:	增加批号	123456	5.65	0.11	29	1.95	2.20	5.6	0.12	2.14
钠 (mmol/L)	结果	是	厂家名称	1:3s/2:2s	增加批号	HE1234	110	1.39	30	1.26	1.28	111	1.42	1.28
钠 (mmol/L)	结果	是	厂家名称	1:3s/2:2s	删除批号	HE1234	145	1.75	30	1.21	1.29	146	1.83	1.25
氯 (mmol/L)	结果				增加批号									
总钙 (mmol/L)	结果				增加批号									
磷 (mmol/L)	结果	否			增加批号									
血糖 (mmol/L)	结果	否			增加批号									
尿素 (mmol/L)	结果	否			增加批号									
尿酸 (μmol/L)	结果				增加批号									
肌酐 (μmol/L)	结果				增加批号									
总蛋白 (g/L)	结果				增加批号									
白蛋白 (g/L)	结果				增加批号									
胆固醇 (mmol/L)	结果				增加批号									

原始数据不需上报

若指定项目未开展室内质控请点击“否”

若多个水平质控物请点击“增加批号”

图 1 室内质控数据回报页面示例

注：

1. 在打开 EQA 质评上报表时，将首先出现 IQC 数据上报表，待回报 IQC 数据后才能进入 EQA 回报页面。
2. 若有多个水平质控物，请点击“增加批号”；
3. 若指定的项目未开展室内质控，在“是否开展 IQC”一栏选“否”。
4. 质控原始数据不需上报

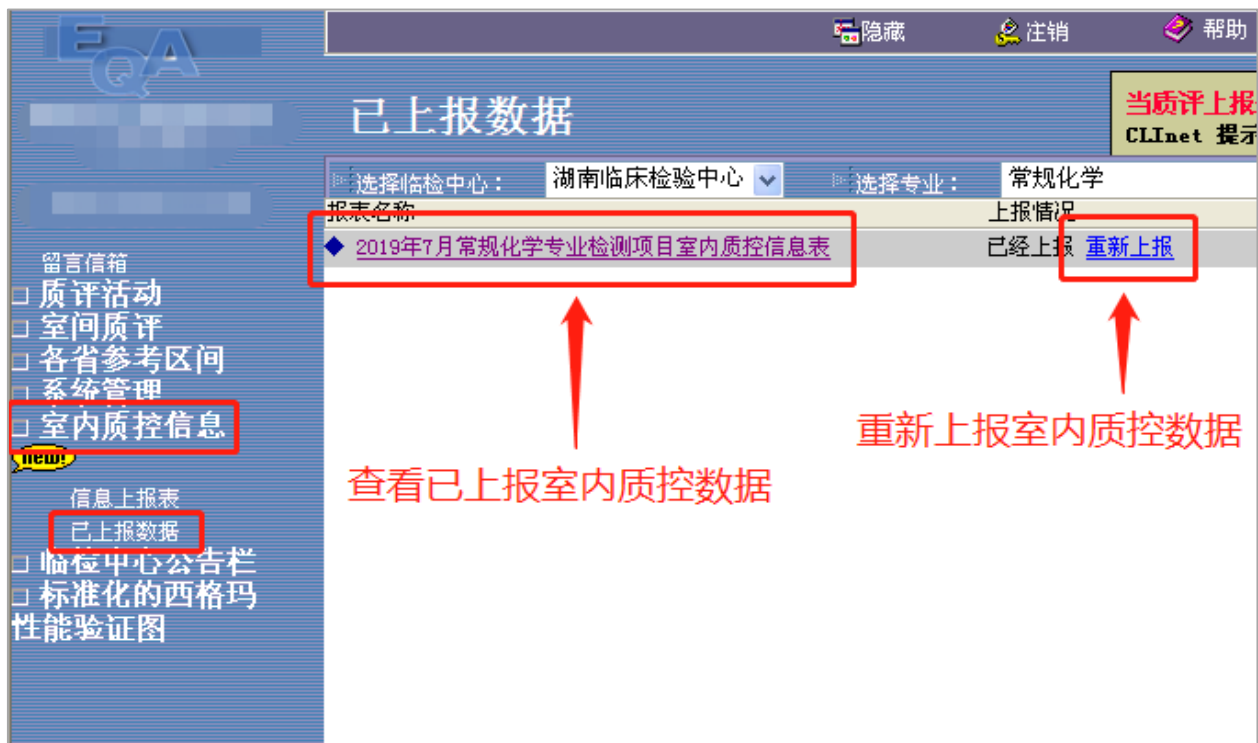


图 2 室内质控数据查看、重报或修改页面示例



图 3 室内质控数据回报表的选择和继续上报页面示例

注：若在填报时不慎关闭了 IQC 上报页面，再次打开 EQA 回报表时，将不再弹出 IQC 上报页面，请参照上图点击相应月份的回报表再次上报或点击“继续上报”。