

基于 Web 室间质评软件回报室内质控数据 操作程序

- 1、打开湖南省临床检验中心网站
(www.hncc1.com.cn), 在“EQA 会员登陆”处, 输入实验室编码和密码登陆。
- 2、进入室间质评回报页面, 打开质评上报表, 将首先出现室内质控数据上报表, 待回报室内质控数据后才能进入 EQA 回报页面。
- 3、需上报的专业和项目见每次室间质评活动通知。回报方式可选择在线填报或导入电子表格填报方式。(见图 1)
- 4、若有多个水平质控物, 请点击“增加批号”; 若参评项目未开展室内质控, 在“是否开展 IQC”一栏选“否”或不填, 该项目所在行其他部分不要再填写任何数据。每日的质控原始数据不需上报。
- 5、用数值判定结果的定性项目, 可按定量项目方式填报; 直接判定结果的定性项目, 质控规则处填写“定性”, 均值、SD、CV%处填 0 代替, 其他部分可正常填写。
- 6、填报完毕后, 建议点击“保存”后, 再点击“发送”。若需要查看已上报数据、重报或修改数据, 可点击页面左侧“室内质控信息”主菜单, 进入“已上报数据”页面进行相关操作(见图 2)。若在填报途中不慎关闭了 IQC 上报页面, 或未出现 IQC 上报页面, 可点击“室内质控信息”主菜单, 进入“信息上报表”, 选择专业, 点击相应月份的回报表再次上报或点击“继续上报”(见图 3)。

室内质控（IQC）数据回报操作图示

（一、在线填报方式）

项目	原始数据	是否开展IQC	质控物生产厂家名称	采用质控规则	质控物具体批号	3月在控质控结果的平均值	3月在控质控结果的标准差(SD)	3月在控质控结果的个数(N)	3月在控数据变异系数(CV%)	累积在控数据的变异系数(CV%)	你室绘制质控图平均值	你室绘制质控图标准差(SD)	你室绘制质控图变异系数(CV%)
WBC(10 ⁹ /L)	结果	<input type="checkbox"/>			增加批号								
RBC(10 ¹² /L)	结果	<input type="checkbox"/>			增加批号								
Hgb(g/L)	结果	<input type="checkbox"/>			增加批号								
Hct(%)	结果	<input type="checkbox"/>			增加批号								
Plt(10 ⁹ /L)	结果	<input type="checkbox"/>			增加批号								
MCV(fl)	结果	<input type="checkbox"/>			增加批号								
MCH(pg)	结果	<input type="checkbox"/>			增加批号								
MCHC(g/L)	结果	<input type="checkbox"/>			增加批号								

如有多水平质控，请点击“增加批号”

（二、导入电子表格填报方式）

(1) 质控品生产厂家名称、采用质控规则、质控物具体批号可以填写中文、英文、数字和符号。
(2) 质控品平均浓度、质控物浓度标准差、当月在控制数据变异系数和累计在控制数据变异系数栏中填写数字，小数点后面可以保留3位。
(3) 当月质控结果个数：填写整数。
(4) “原始数据”可以不上报。

点击“下载模板”，在导出的表格中填好数据，再点击“选择文件”，导入已填写的数据。

您可以先下载模板，在模板上填写数据，然后导入 未选择任何文件 如有多水平质控，可手工增加一行，复制项目名称，再进行填写。

(温馨提示：如果您点击过本上报表的“保存”按钮，当再次打开本上报表后，请先点击“加载”按钮，以免覆盖您曾经保存过的数据)

图 1 室内质控数据回报页面示例

操作提示：

1. 在打开 EQA 质评上报表时，将首先出现 IQC 数据上报表，待回报 IQC 数据后才能进入 EQA 回报页面。建议先整理好 IQC 数据后再行上报，若分多次填写，可点击“保存”，下次打开窗口后点击“加载”，可继续填写。如未出现 IQC 上报页面，见图 3 操作。
2. 若有多个浓度水平质控物，请点击“增加批号”，将会增加一行相同项目的填写位置，请注意不同浓度质控物的批号不同，填写时注意区别。
3. 除上述在线回报方式外，还可选择导入 EXCEL 中的数据。请点击“下载模板”，在导出的电子表格中填好数据后，再点击“选择文件”，导入该表格。如有多水平质控，可手工增加一行，将“项目”列名称复制，再进行填写。如该专业所有项目均有多个水平，可将“项目”列整体复制，粘贴在下方再进行填写，导入时系统会按项目自动识别。
4. 质控原始数据不需上报。

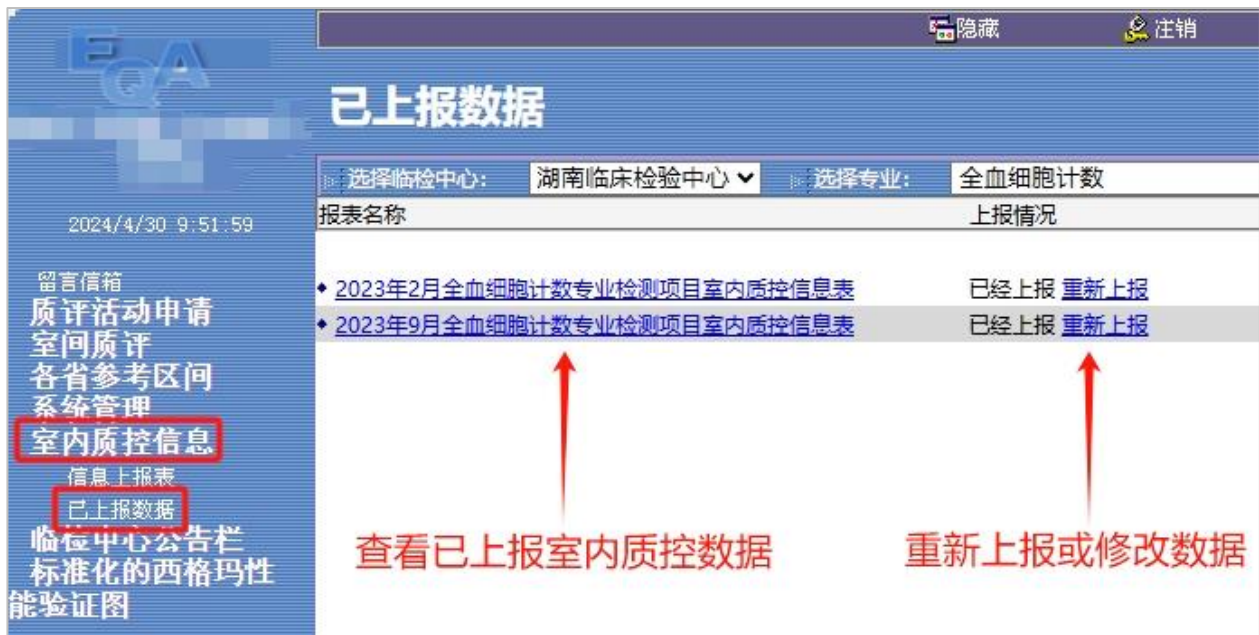


图2 室内质控数据查看、重报或修改页面示例

注：如需对已上报数据进行修改，点击“重新上报”，将提示删除之前的数据，删除进入回报页面后，点击“加载”（见图1），将出现之前已保存的数据，然后再行修改。



图3 室内质控数据回报表的选择和继续上报页面示例

注：若在填报时不慎关闭了 IQC 上报页面，或未出现 IQC 上报页面，请参照上图点击相应月份的回报表进行上报或点击“继续上报”。已上报项目的数据将不再出现在“继续上报”的页面。